


大连市计量检测研究院

Dalian Institute of Measurement and Testing

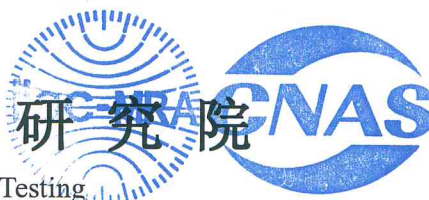

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L1187

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: S189991455 号
Certificate No.

委托单位: 大连云动力科技有限公司
Customer
地址: 大连市甘井子区虹港路 23 号
Address
器具名称: 轻松连无线智能感知设备
Name
制造者: /
Manufacturer
型号/规格: WS1PRO
Model/Type
出厂编号: 8159P
Serial No.
接收日期: 2018 年 08 月 06 日
Receipt Date
接收状态: 良好
Description

批准人 李颖
Approved by

核验员 李颖
Checked by

校准员 李颖
Calibrated by

校准日期 2018 年 08 月 06 日
Calibration Date Year Month Day

地址: 大连市甘井子区西南路 1 号绿洲园 67 号

电话 (Tel): 0411-86713872

Address: No.67, Lvzhouyuan, No.1, Xi'n'an Road, Ganjingzi District, Dalian.

传真 (Fax): 0411-86713880

电子邮箱 (E-mail): dljlskf@163.com

邮编 (Post Code): 116033

大连市计量检测研究院

Dalian Institute of Measurement and Testing

证书编号: S189991455

第 2 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本实验室经中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可, 证书号: No. CNAS L1187
CNAS certificate of laboratory accreditation :No. CNAS L1187

2. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准。

All data issued by the laboratory are traceable to national standards of measurement.

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称	型号/规格	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
Name of equipment	Model/Type	U /AC/MPE	Certificate No.	Valid date to
精密露点仪	DewMaster	MPE : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ DP	辽计 17020538854	2018-09-17

4. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

JJF1076-2001 湿度传感器校准规范

5. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

校准地点	温度($^{\circ}\text{C}$)	相对湿度(%RH)
Place	Temperature	Relative humidity
本院	20	/

6. 说明 (Explain):

被校准仪器在使用过程中, 如遇有修理或对其技术指标产生怀疑时, 建议重新校准。

The instrument should be calibrated renewedly, if the instrument is repaired in using or you have doubt on the technique indicators.

根据客户要求 and 校准文件的规定, 通常情况下 12 个月校准一次。

According to customer demand and verify file, the instrument should be calibrated per 12 months normally.

注 (Note):

1. 本实验室仅对加盖 “大连市计量检测研究院校准专用章” 的完整证书负责。

The laboratory will only be responsible for the intact certificate with the “Dalian Institute of Measurement and Testing Calibration Precincts Stamp”.

2. 本校准结果仅对本次所校准的器具有效。

The report only to be responsible for the instrument calibrated.

大连市计量检测研究院

Dalian Institute of Measurement and Testing

证书编号: S189991455

第 3 页 共 3 页

Certificate No.

Page of

校准结果

Results of Calibration

湿度:

标称值 %RH	实测值 %RH	扩展不确定度 U %RH($K=2$)
40	41	1
60	57	2
80	75	2

温度:

标称值/ $^{\circ}\text{C}$	实测值/ $^{\circ}\text{C}$	扩展不确定度 U / $^{\circ}\text{C}$ ($K=2$)
6.2	5.9	0.4
14.4	14.2	0.4
20.0	19.9	0.4

.....以下空白.....

注 (Note):

1. 本实验室仅对加盖“大连市计量检测研究院校准专用章”的完整证书负责。

The laboratory will only be responsible for the intact certificate with the “Dalian Institute of Measurement and Testing Calibration Precincts Stamp”.

2. 本校准结果仅对本次所校准的器具有效。

The report only to be responsible for the instrument calibrated.